



مرکز آمار و فناوری اطلاعات
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

حوزه توسعه و مدیریت منابع

دفتر آمار و فناوری اطلاعات

تاریخ ۰۶ تیر ۱۴۰۱

دستورالعمل راهنمای سامانه غربالگری سندورم داون - رادیولوژیست

شماره ۱۴۰۱۰۴۰۶

مقدمه

با عنایت به تکالیف تعیین شده برای تحقق ماده ۵۳ و ۵۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سند دستورالعمل فوق جهت فرآیند رادیولوژیست‌ها ایجاد شده است.

محدوده

محدوده این دستورالعمل شامل تمامی رادیولوژیست ثبت غربالگری کشور می باشد. بدیهی است تمامی رادیولوژیست‌ها موظف به اجرای این دستورالعمل در راستای اجرای مواد قانونی، موضوع ماده ۵۳ و ۵۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت کشور می‌باشند.

تعاریف

تست‌های غربالگری دوران بارداری: به مجموعه‌ای از بررسی‌های سونوگرافی و آزمایشگاهی گفته می‌شوند که در مراحل مختلف انجام شده و هدف آن این است که مادران باردار را از لحاظ ابتلای جنین به برخی از سندرم‌ها و نقایص جنینی (نه همه نقایص) غربال کرده و آن‌ها را در گروه‌های کم خطر یا پر خطر قرار دهند. در واقع این تست‌ها نمی‌توانند به طور یقین مشخص کننده‌ی وجود اختلال در جنین باشند، بلکه اگر نتیجه‌ی تست‌ها مثبت باشند احتمال وجود نقص بالاتر از دیگران است. به همین خاطر بعد از انجام تست‌های غربالگری، پزشک شما ممکن است درخواست تست‌های تشخیصی دهد تا از سالم بودن جنین مطمئن شود. اگر نتیجه‌ی تست غربالگری منفی باشد یعنی احتمال به دنیا آمدن نوزادی همراه با نقص آنقدر پایین است که احتیاج به پیگیری ندارد.

اصول و ضوابط

همکاران محترم پزشک، برای اولین ورود به سامانه، روی گزینه "ثبت نام کنید" کلیک کنید و وارد صفحه ثبت مشخصات خود شوید. نام کاربری و رمز عبور برای شما پیامک می‌شود و در دفعات بعدی ورود به سامانه، نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نموده و بلافاصله وارد صفحه نسخه نویسی و ارایه خدمت شوید.

شماره ۱۴۰۱۰۴۰۶

تاریخ ۰۶ تیر ۱۴۰۱

صفحه ۲

دستور العمل راهنمای سامانه غربالگری سندورم داون – رادیلوژیست

در صفحه اصلی داشبورد، میانبرهای داشبورد گزارشات روزانه، نسخه نویسی و لیست نسخ وجود دارد. جهت مشاهده نتایج آزمایشات و سونوگرافی، بارگزاری گزارشات سونوگرافی و ثبت توضیحات مرتبط با غربالگری ناهنجاری جنین، با نقش "پزشک" می توانید روی میانبر نسخه نویسی کلیک کنید. در باکس مربوط به کد ملی، کد ملی فرد را وارد کنید و روی دکمه جستجو کلیک کنید.

دستور العمل راهنمای سامانه غربالگری سندورم داون – رادیلوژیست

شماره ۱۴۰۱۰۴۰۶

تاریخ ۰۶ تیر ۱۴۰۱

صفحه ۳

با زدن دکمه جستجو، استعلام اطلاعات هویتی فرد به صورت اتومات انجام می شود. تاریخ تولد و شماره تماس والدین (جهت اطلاع رسانی و پیگیری های بعدی) را در باکس های مربوطه ثبت کنید و پس از مشاهده و تایید اطلاعات ، نوع بیمه را انتخاب کرده و وارد صفحه نسخه نویسی شوید.

تاریخ تولد: ۱۳۶۷/۰۸/۱۵

تلفن همراه را وارد کنید: ۰۹۱۵۵۱۰۳۳۲۵

نوع بیمه را انتخاب کنید: آزاد

صدور نسخه جدید

در صفحه نسخه نویسی ، تب های مختلف تعریف شده است که با کلیک کردن روی هر کدام از این تب ها ، دسترسی درخواست خدمت موردنظر از جمله درخواست آزمایشات غربالگری ناهنجاری جنین ، درخواست سونوگرافی NT و باز می شود .

دستور العمل راهنمای سامانه غربالگری سندروم داون - رادیلوژیست

شماره ۱۴۰۱۰۴۰۶

تاریخ ۰۶ تیر ۱۴۰۱

صفحه ۴

The screenshot shows the Radilogy system interface. At the top, there is a header with the Ministry of Health and Medical Education logo and the text 'سازمان بهداشت، درمان و آموزش پزشکی'. Below this, patient information is displayed: 'نام و نام خانوادگی: حسین بوسعید', 'تاریخ تولد: ۱۳۶۷/۰۸/۱۵ (۳۸ سال و ۷ ماه و ۲۱ روز)', 'کد ملی: ۹۳۸۱۳۸۴۳۱', 'جنسیت: مرد', 'تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۱۰۲۳۲۵', and 'پیمه: آزاد'. A menu bar contains several items: 'دارو', 'آزمایش', 'تصویربرداری', 'فیزیوتراپی', 'خدمات', 'معاینات', and 'ثبت نهایی'. Two red boxes highlight the 'دارو' and 'آزمایش' items. Below the menu, there are several form fields for 'نام دارو', 'تعداد', 'زمان مصرف', 'نوع مصرف', 'نوع کتید', and 'توضیحات'. There are also buttons for 'افزودن' and 'ثبت نسخه پر مصرف'.

جهت مشاهده سوابق دارویی ، نتایج آزمایشات و تصویربرداری و روی تب موردنظر کلیک کنید و روی علامت \bar{i} مطابق تصویر کلیک کنید . وارد صفحه سوابق درخواستهای بیمار و گزارشات جواب آزمایشات و سونوگرافی و ... شوید .

The screenshot shows a detailed view of a test result in the Radilogy system. The header is the same as in the previous screenshot. The menu bar is also present, with red boxes highlighting 'دارو' and 'آزمایش'. Below the menu, there is a section for 'نام آزمایش' with a dropdown menu showing 'داون'. The main content area displays the test name: 'PAPP-A - ۴۸۷۹۸-۳ - دابل مارکر برای غربالگری سندروم داون شامل (PAPP-A+FreeBeta)'. Below this, there is a detailed description of the test: 'inhibinA+ aFP+ Beta شامل داون سندروم داون شامل quad maternal screen panel - کوادریپل مارکر برای غربالگری سندروم داون (این کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعایت استانداردهای ایلاچی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ۹۰ درصد چزه فنی و ۵ درصد چزه حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.) (قیمت تولید داده خام به عنوان بخشی از چزه فنی براساس اعلام رسمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت دوره ای قابل محاسبه و پرداخت می باشد.)'. There is also a section for 'نام آزمایش' with a dropdown menu showing 'داون' and a detailed description of the test: '(aFP+Beta titer+unconjugated Estriol) سندروم داون (این کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعایت استانداردهای ایلاچی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ۹۰ درصد چزه فنی و ۵ درصد چزه حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.) (قیمت تولید داده خام به عنوان بخشی از چزه فنی براساس اعلام رسمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت دوره ای قابل محاسبه و پرداخت می باشد.)'.


دستور العمل راهنمای سامانه غربالگری سندرم داون – رادیلوژیست

شماره ۱۴۰۱۰۴۰۶

تاریخ ۰۶ تیر ۱۴۰۱

صفحه ۵

لیست نسخ بیمار به شما نشان داده می شود که با کلیک کردن روی هر کدام از نسخ، جزئیات جواب آزمایش یا تصویربرداری را می توانید مشاهده کنید.

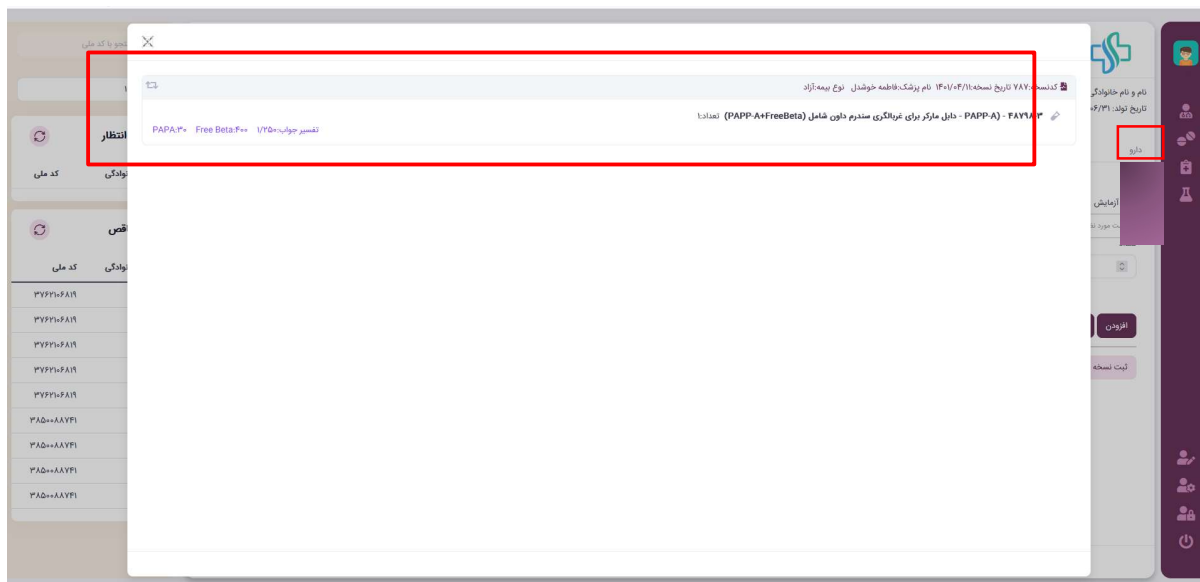

در تب "معاینات" امکان بارگذاری فایل و تصاویر دارید که از این قسمت میتوانید برای آپلود تصاویر یا گزارشات سونوگرافی، مستندات پزشکی قانونی و ... استفاده کنید. روی آیکن "بارگذاری تصویر" کلیک کنید. از قسمت انتخاب فایل، فایل موردنظر را آپلود کرده و روی دکمه "افزودن" کلیک کنید.

دستور العمل راهنمای سامانه غربالگری سندورم داون – رادیلوژیست

شماره ۱۴۰۱۰۴۰۶

تاریخ ۰۶ تیر ۱۴۰۱

صفحه ۶

The screenshot displays the 'Form Completion' page for the 'Dawn' screening system. The page is divided into several sections:

- Header:** Includes the system logo and the title 'تکمیل فرم غربالگری سندورم داون' (Form Completion).
- Patient Information:** Displays personal details such as name, date of birth, gender, and contact information.
- Services List:** A list of services including 'تصویربرداری' (Imaging), 'فیزیوتراپی' (Physiotherapy), 'خدمات' (Services), 'معاینات' (Examinations), and 'ثبت نهایی' (Final Registration).
- Form Fields:** A series of input fields for data entry, including 'وزن (kg)', 'تاریخ تشخیص', 'شدت بیماری', and 'انتخاب کنید' (Select).
- File Upload:** A section for uploading files, with a 'Choose File' button and a 'No file chosen' message.

A red box highlights the 'افزودن' (Add) button and the 'File Upload' section, indicating the area of focus for the instructions.

همچنین در تب "معاینات" دسترسی تکمیل "فرم اطلاعات غربالگری سندورم داون" به پزشک داده شده است که با انتخاب این گزینه می توانید اطلاعات مورد نیاز غربالگری سندورم داون مانند تاریخ LMP، تعداد زایمان و ... و اطلاعات سونوگرافی مانند تاریخ انجام سونوگرافی، اندازه CRL در جنین و ... را تکمیل و ثبت کنید.

دستور العمل راهنمای سامانه غربالگری سندروم داون - رادیولوژیست

شماره ۱۴۰۱۰۴۰۶

تاریخ ۰۶ تیر ۱۴۰۱

صفحه ۷

This screenshot shows the 'فرم غربالگری سندروم داون' (Down Syndrome Screening Form) in the radiologist interface. The form includes fields for patient information such as name, date of birth, sex, and phone number. It also features a 'تکمیل فرم غربالگری سندروم داون' (Complete Down Syndrome Screening Form) button, a file upload section with a 'Choose File' button, and various input fields for clinical data like weight (وزن), BMI, and symptoms (توضیحات). The interface includes a sidebar with navigation icons and a top navigation bar with the system logo.

This screenshot shows the 'فرم اطلاعات غربالگری سندروم داون' (Down Syndrome Screening Information Form) in the radiologist interface. It contains several fields for clinical information, including 'تاریخ LMP' (LMP Date), 'تعداد زایمان (Parity):' (Parity), 'تعداد بارداری (Gravidity):' (Gravidity), 'سابقه ابتلا به دیابت:' (Diabetes history), and 'سابقه مصرف دخانیات:' (Smoking history). The interface includes a sidebar with navigation icons and a top navigation bar with the system logo.

شماره ۱۴۰۱۰۴۰۶

تاریخ ۰۶ تیر ۱۴۰۱

صفحه ۸

دستور العمل راهنمای سامانه غربالگری سندورم داون - رادیولوژیست

اطلاعات سونوگرافی

۱- تاریخ انجام سونوگرافی:

۲- نام سونوگرافیست:

۳- اندازه CRL درجینین:

۴- اندازه NT:

۵- تعداد جنین زنده:

۶- توضیحات سونوگرافی:

چسبجو یا کد ملی: ۱۴۰۱/۰۴/۰۶

لیست انتظار: نام و نام خانوادگی، کد ملی

نسخ ناقص: نام و نام خانوادگی، کد ملی

چنانچه درخواست های شما کامل شده است در انتها می توانید با انتخاب دکمه " ثبت نهایی " ، نسخه خود را ثبت کنید .

آپلود تصویر

ثبت جواب

Biochemistry

Double Marker

PAPA

Free Beta

تفسیر جواب

چسبجو یا کد ملی: ۱۴۰۱/۰۴/۰۶

لیست انتظار: نام و نام خانوادگی، کد ملی

نسخ ناقص: نام و نام خانوادگی، کد ملی

دکمه ملر خدمات سلامت ۱۴۰۱/۰۴/۰۶